

Шаровой кран с патрубками SP150

Очищенные для использования с медицинскими газами и прошедшие 100% гидростатические испытания, эти 3 составные краны для медицинских газов разработаны в соответствии со стандартами NFPA 99с, ISO 7396-1 и G-01.



Техническая спецификация

- Кран имеет 3-х составную полнопроходную шаровую конструкцию, с бронзовым/латунным корпусом, шаром из нержавеющей стали, штоком, болтами и гайками.
- Седло является тефлоновым (RPTFE), а уплотнение - витоновым.
- Краны от 1/2" до 2" имеют минимальное номинальное давление 4137 кПа (600 фунтов на кв. дюйм.) WOG. Краны от 3" до 4" имеют минимальное номинальное давление 2758 кПа (400 фунтов на кв. дюйм) WOG
- Для перевода крана из полностью открытого положения в полностью закрытое требуется лишь четверть оборота.
- Патрубки должны быть типа К длиной не менее 150 мм, чтобы обеспечить пайку без повреждения седла крана и уплотнений вследствие теплопередачи.
- Каждый кран проходит гидростатическое испытание на герметичность.
- Каждый кран промыт и обезжирен для использования с медицинским газом.
- Патрубки закрыты колпачками с обоих концов.
- Краны поставляются в герметичных пластиковых пакетах с маркировкой "Кислород" или "Очищено для использования кислорода", чтобы предотвратить загрязнение перед установкой.
- Краны Silbermann модели SP150 или эквивалентные.
- Все краны соответствуют стандартам NFPA 99, ISO 7396-1 и G-01.

Стандарты медицинских газовых систем:

- NFPA99, EN ISO 7396-1 & G-01 требования.

Система управления качеством Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015.





Шаровой кран с патрубками Модель SP150


Трубопровод
медицинских газов



Размеры [мм]

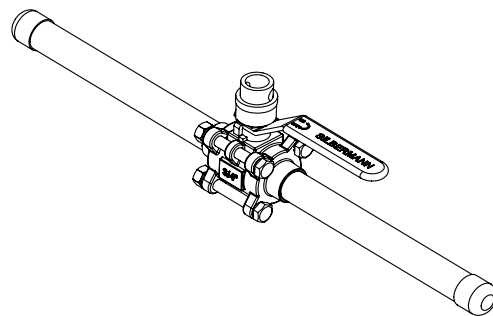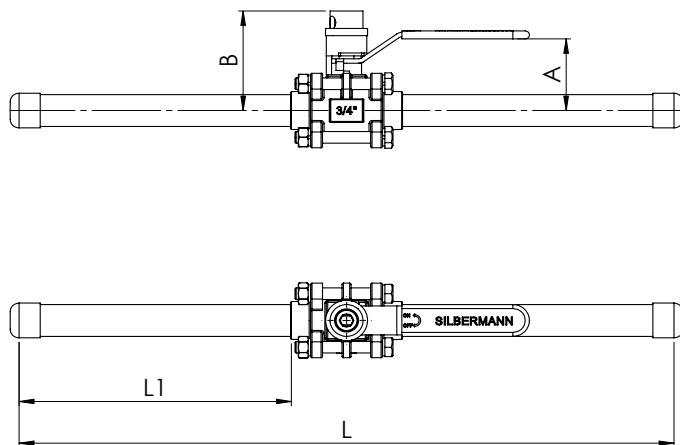

Distributed By:



SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com

 **Silbermann**
Medical Gas Systems Since 1950